

mehreren Meßsendern für den Gesamtbereich 0,5...400 MHz
Eichteiler
Röhrevoltmeter mit Durchgangskopf
Röhrevoltmeter mit Abschlußkopf oder
Tastkopf

wird ersetzt durch
ein einziges Gerät

POLYSKOP

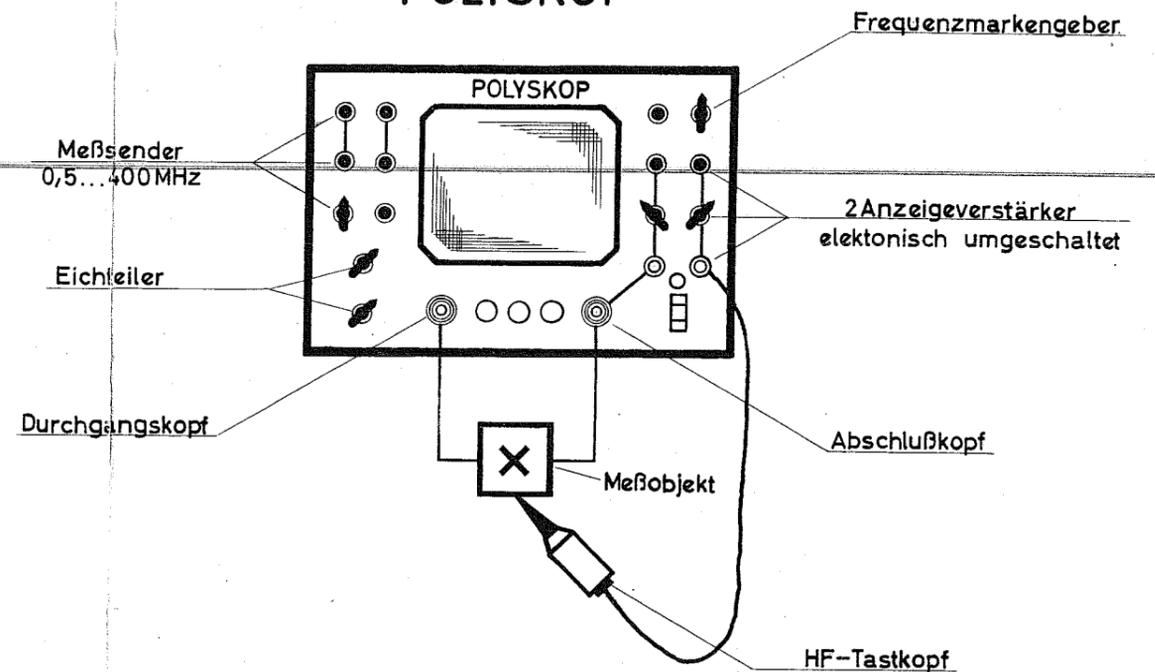


Bild 1

1274
5
1.7

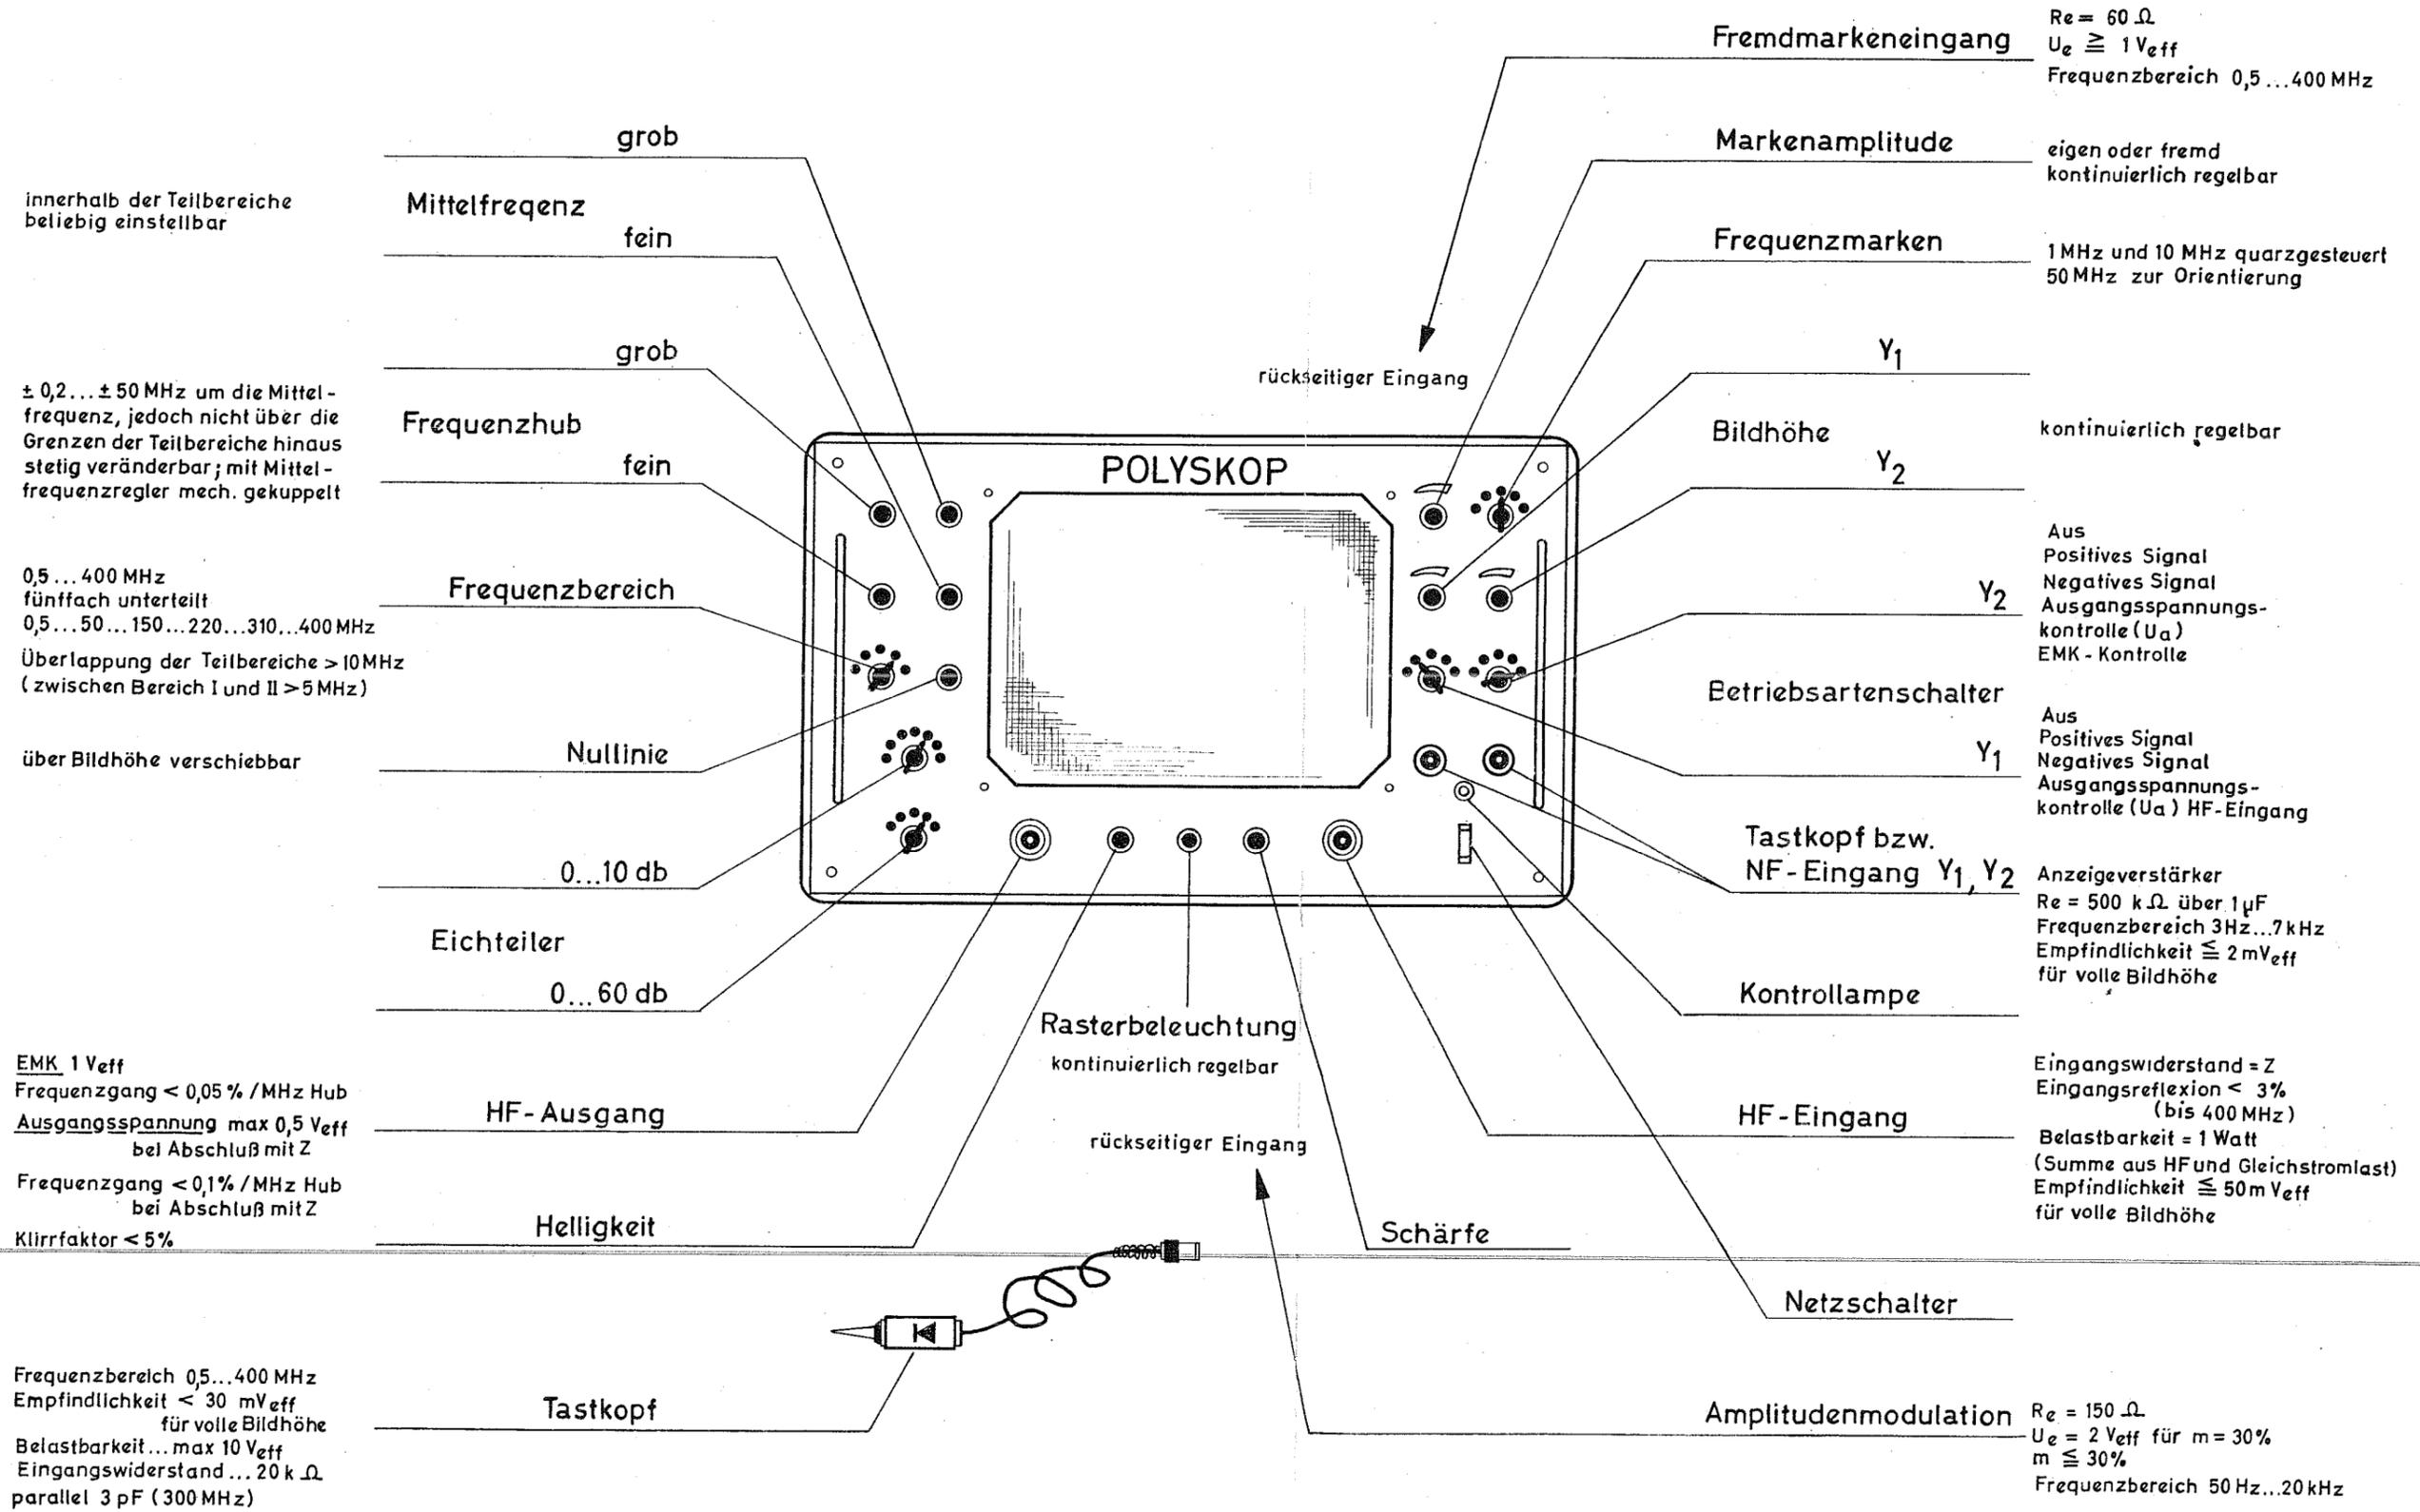


Bild 2. Technische Daten des Polyskop

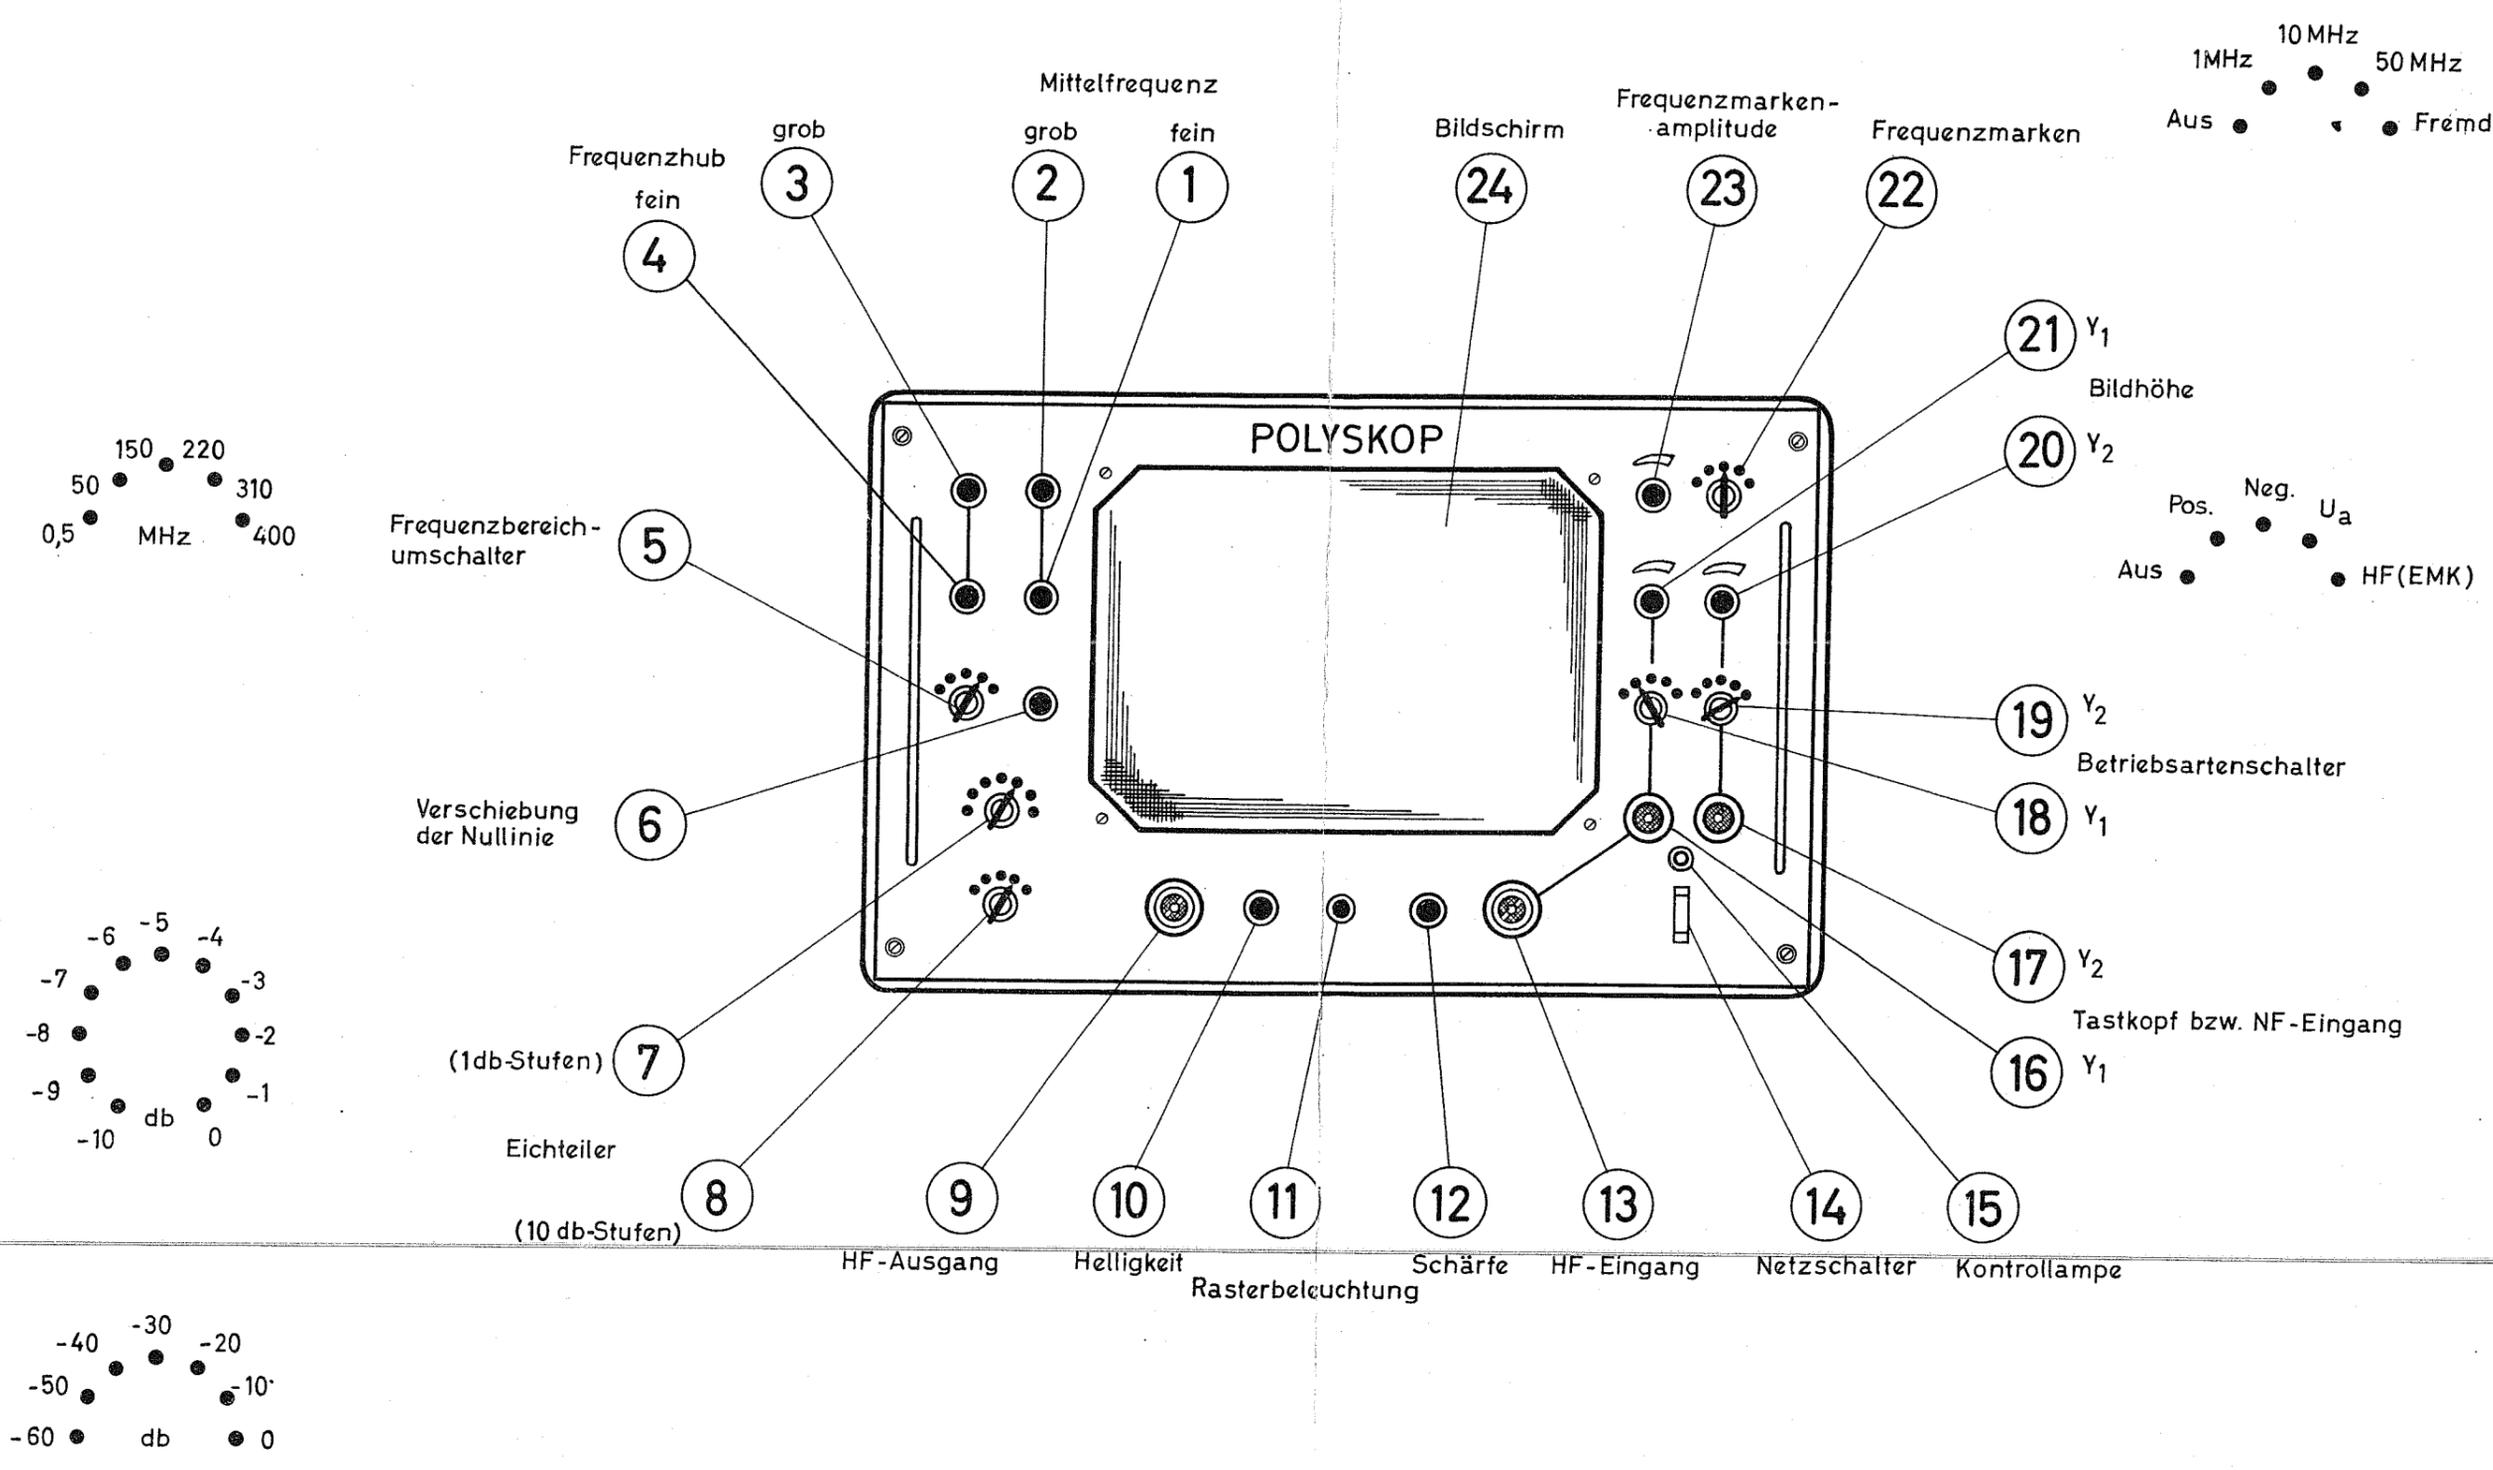


Bild 5. Bedienungsorgane an der Frontplatte

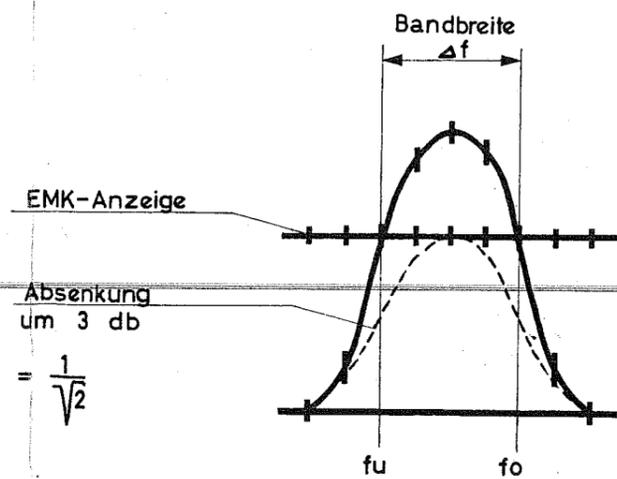
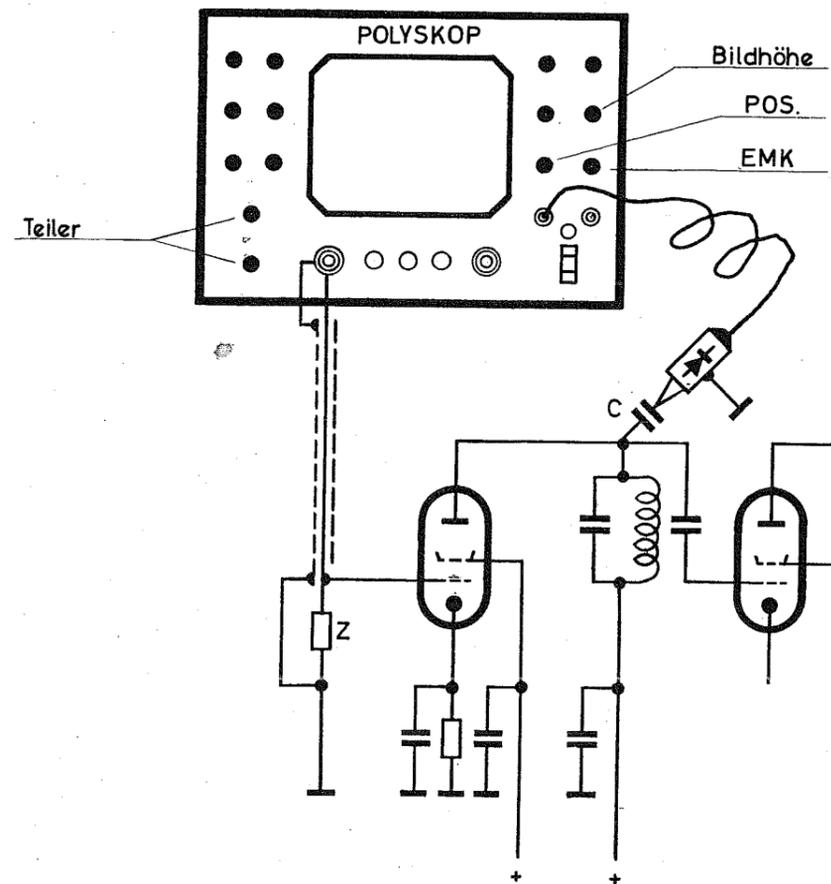


Bild 6. Messung an Einzelkreisen

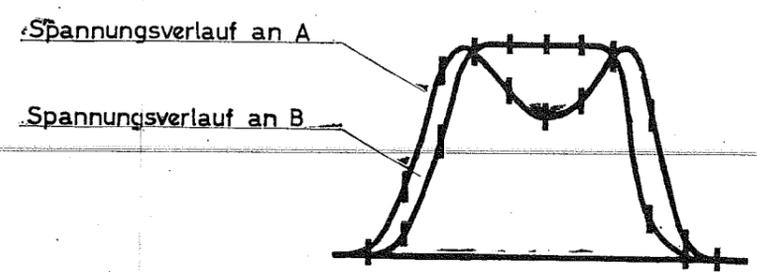
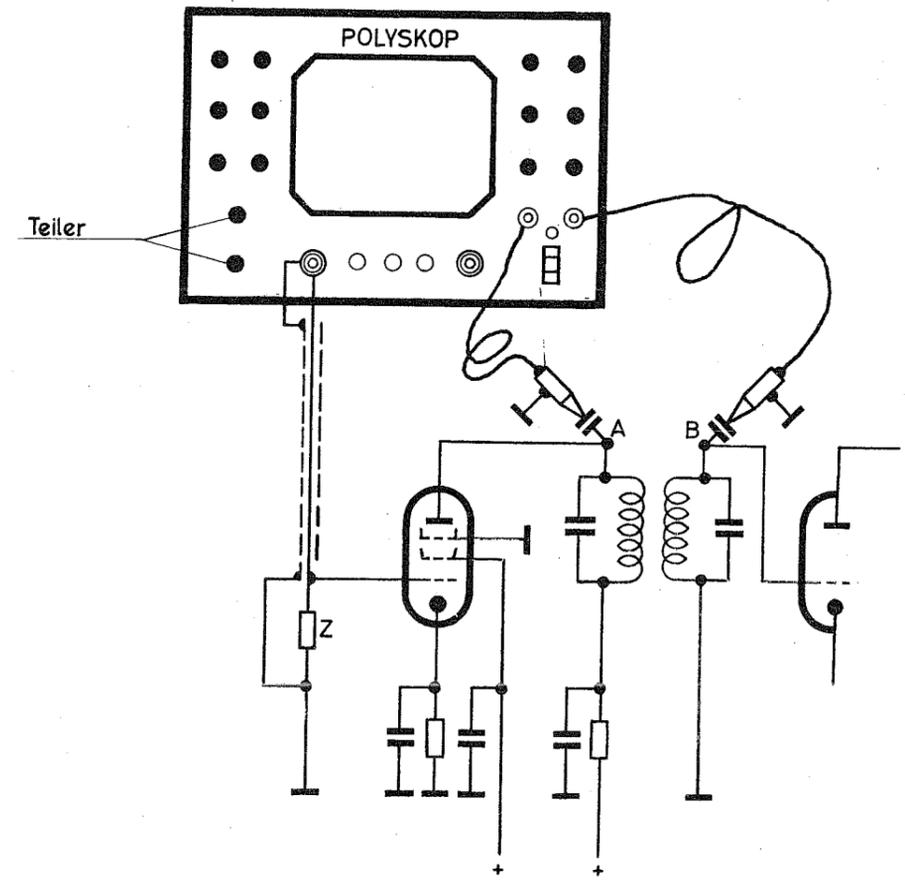


Bild 7. Messung an Bandfiltern