


Betriebsart		Betriebsart			
		I	II	III	IV
A	—	—	—	—	—
B	o	—	—	—	—
C	o	—	—	—	—
Schaltstellung:		1	2	3	4
S I I A	1				
	3,5,7				
	10,12				
	14				
S I I B	16				
	18,20				
S I I C	22,24				
	1				
S I I A	3,5,7				
	10,12				
S I I B	14,16				
	18,20				
S I I C	22,24				
	1				

Schraffierte Felder: Schalter geschlossen

- stetig einstellbar
- in Stufen einstellbar
- o unwirksam

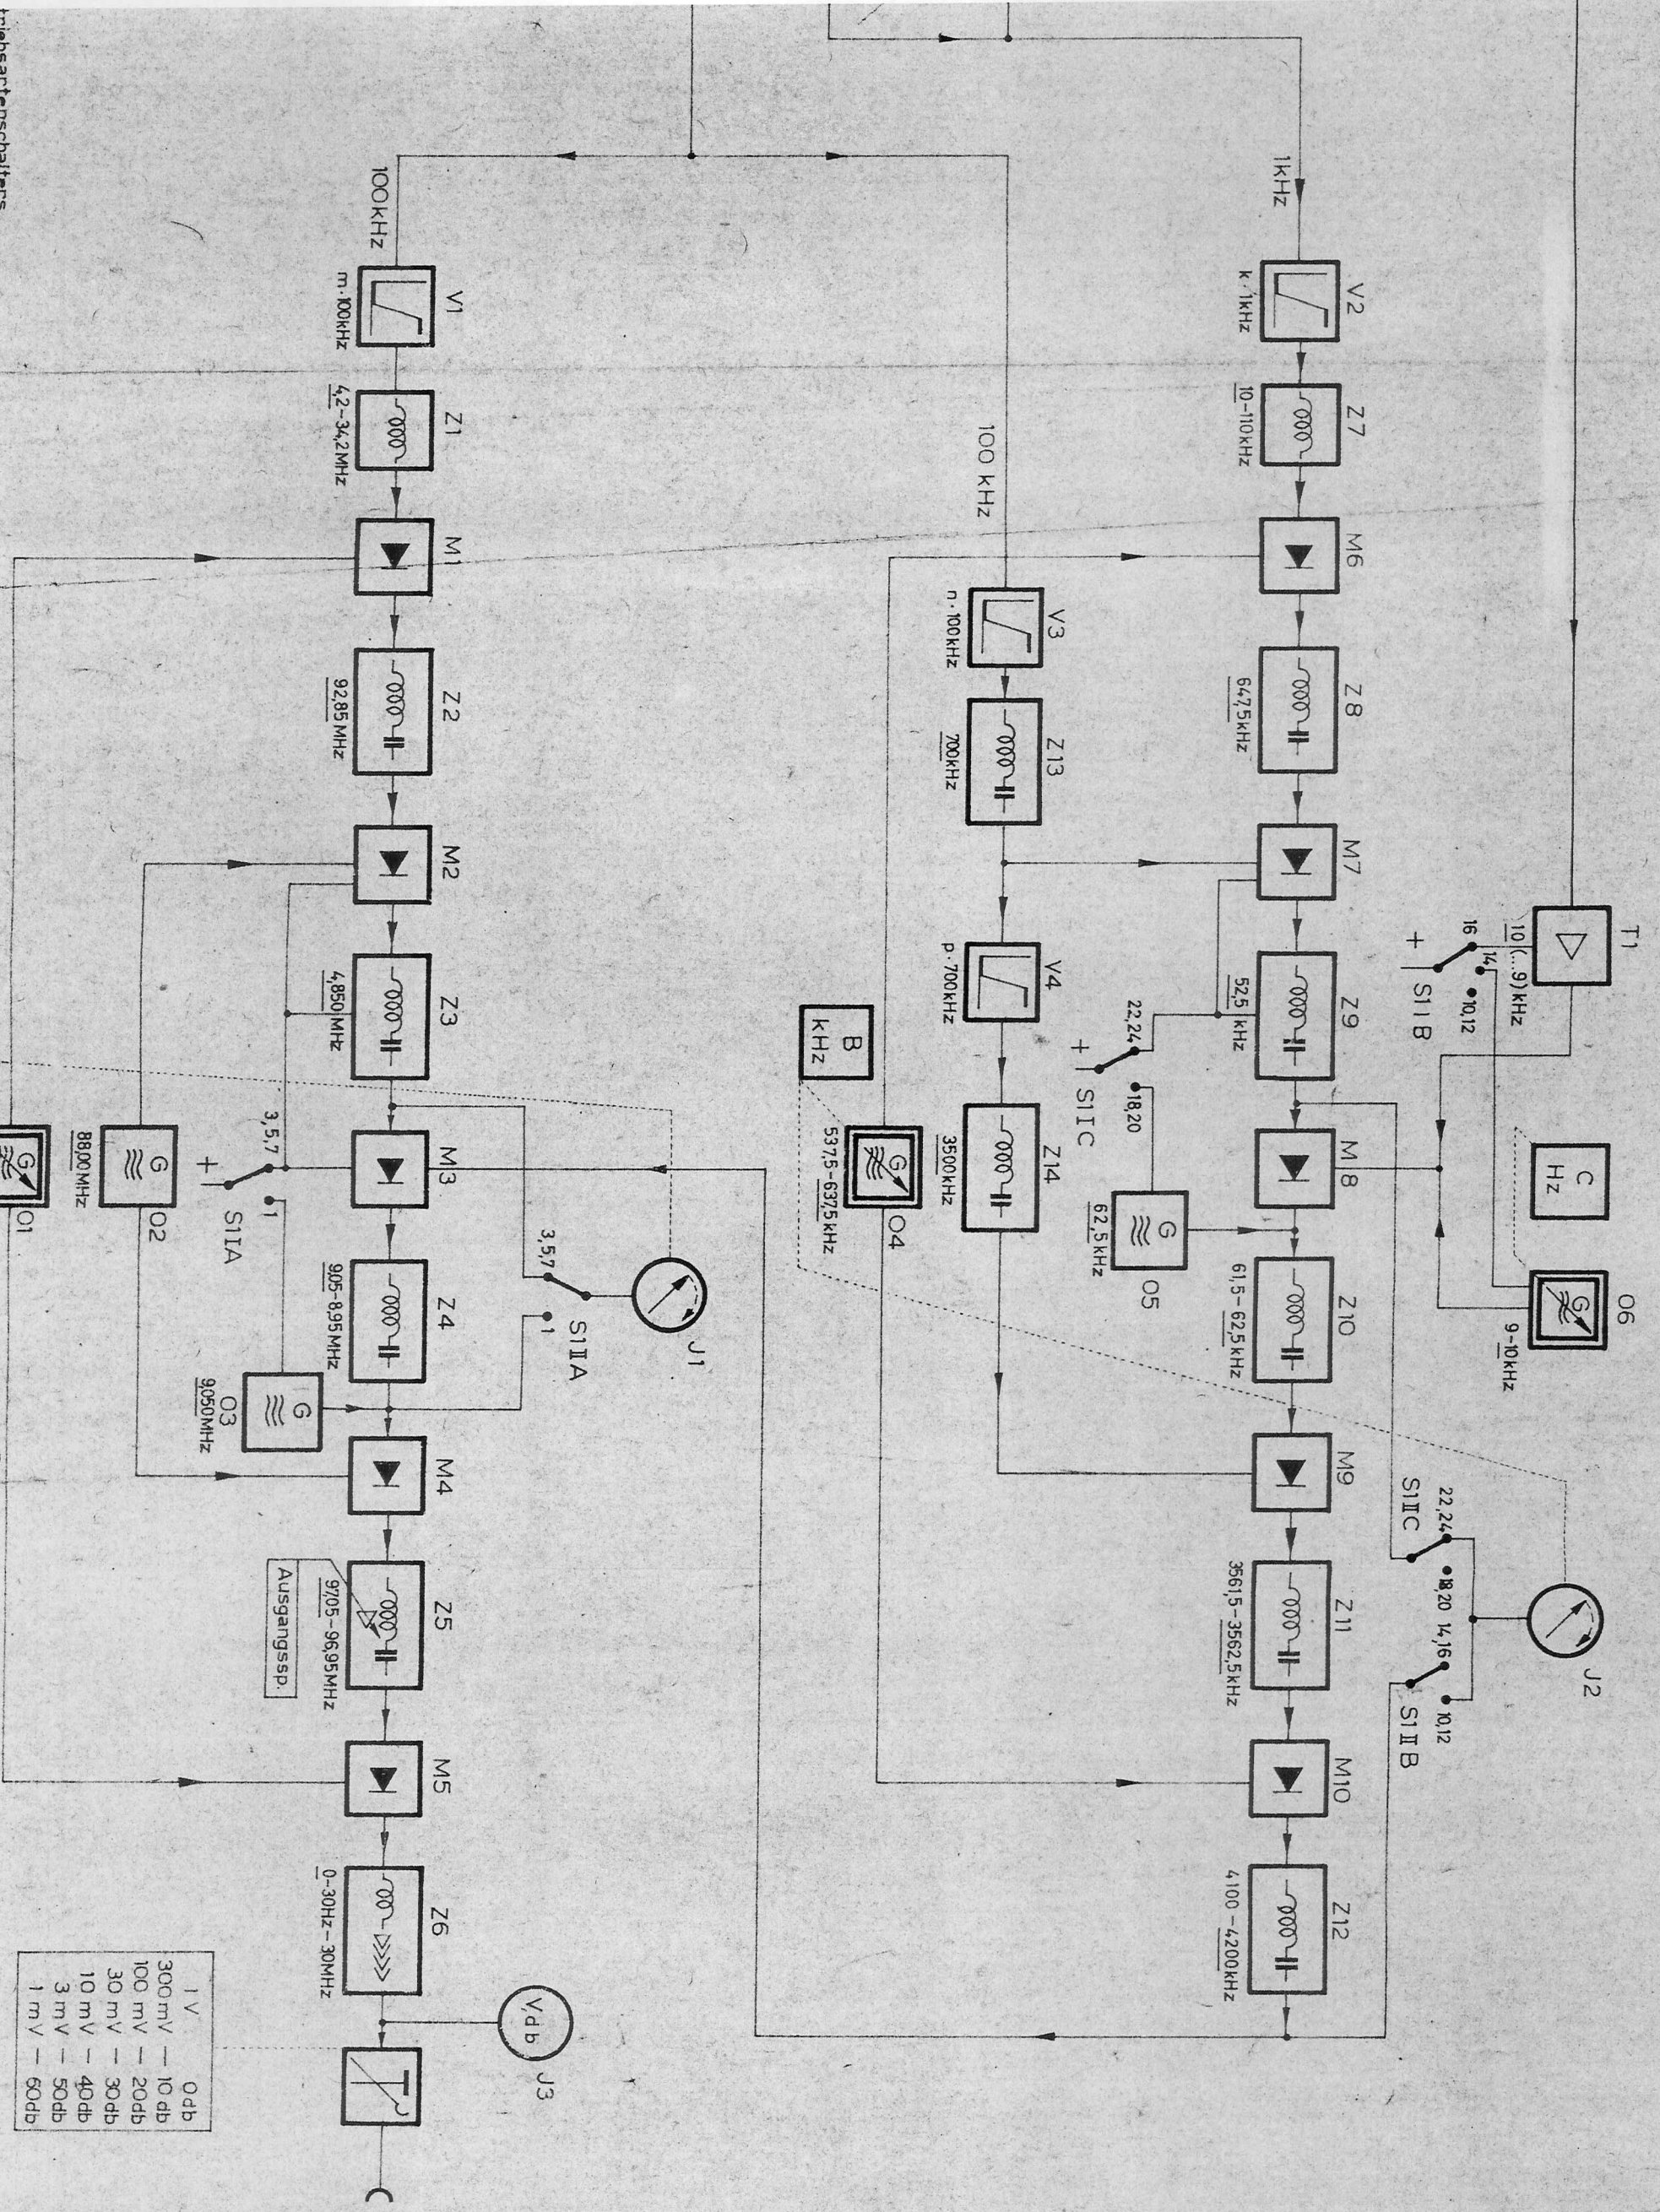


1 V	0 db
300 mV	10 db
100 mV	20 db
30 mV	30 db
10 mV	40 db
3 mV	50 db
1 mV	60 db

Ausgang
30 Hz...30 MHz
R1 60 Ω


Tag	Name	Ans.	Ans. Mittig	Tag	Name


Tag	Name	Ans.	Ans. Mittig	Tag	Name
17.12.10	M	a	—	11.2.60	Ba
		b	—		
		c	—		
		d	—		

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

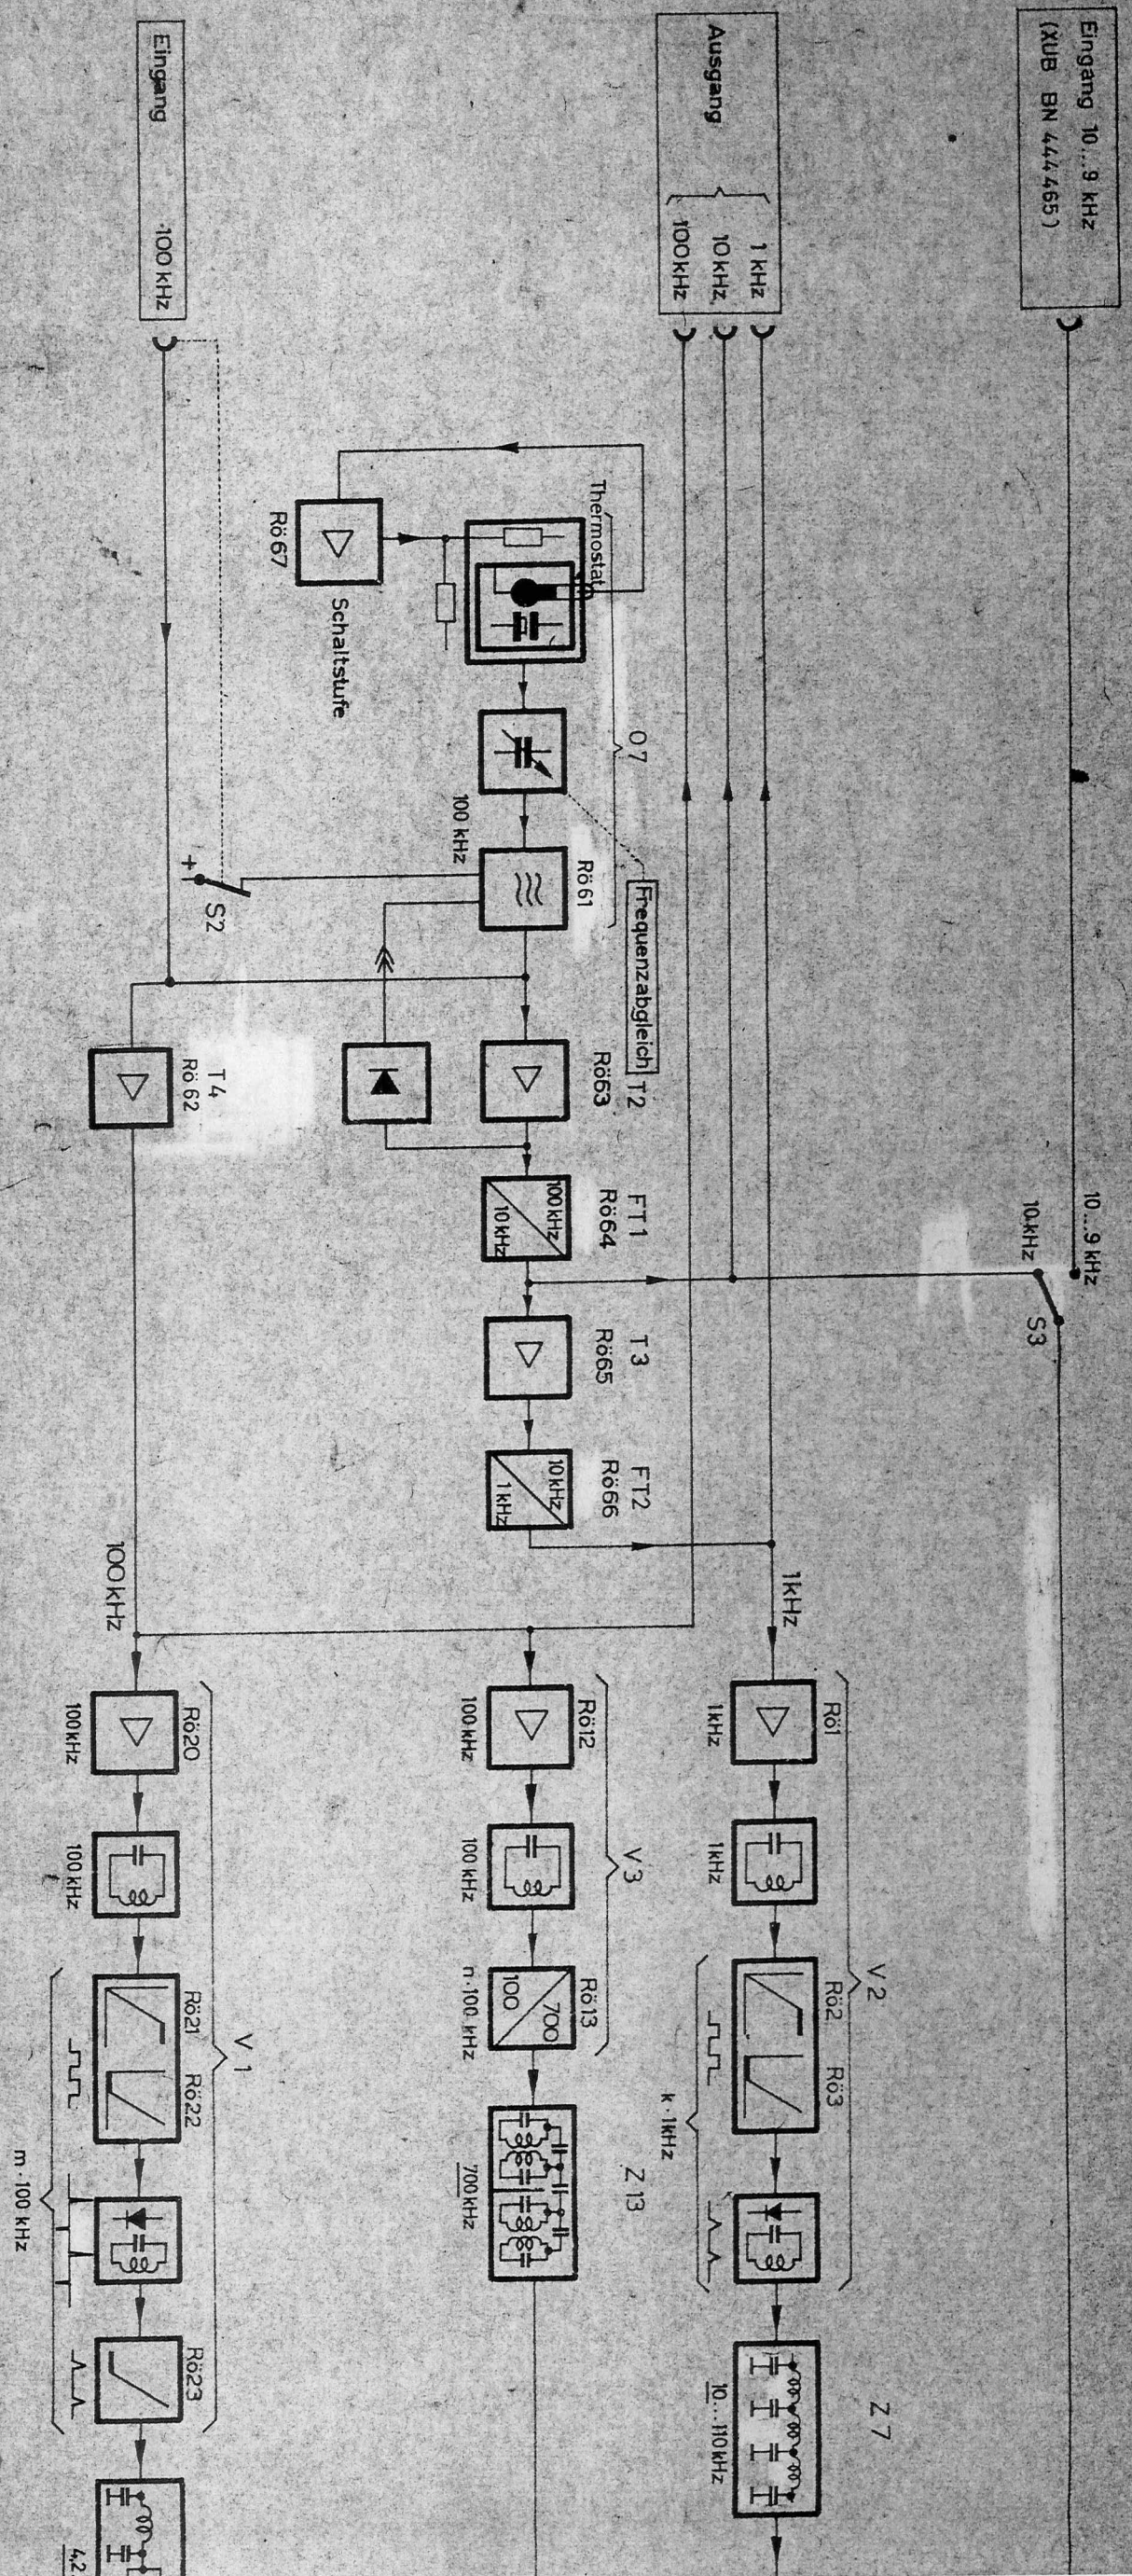

Gezeichnet: Schalterstellung 4 des Betriebsartenschalters
 Unterstrichene Werte gelten für Ausgangsfrequenz Null Hz

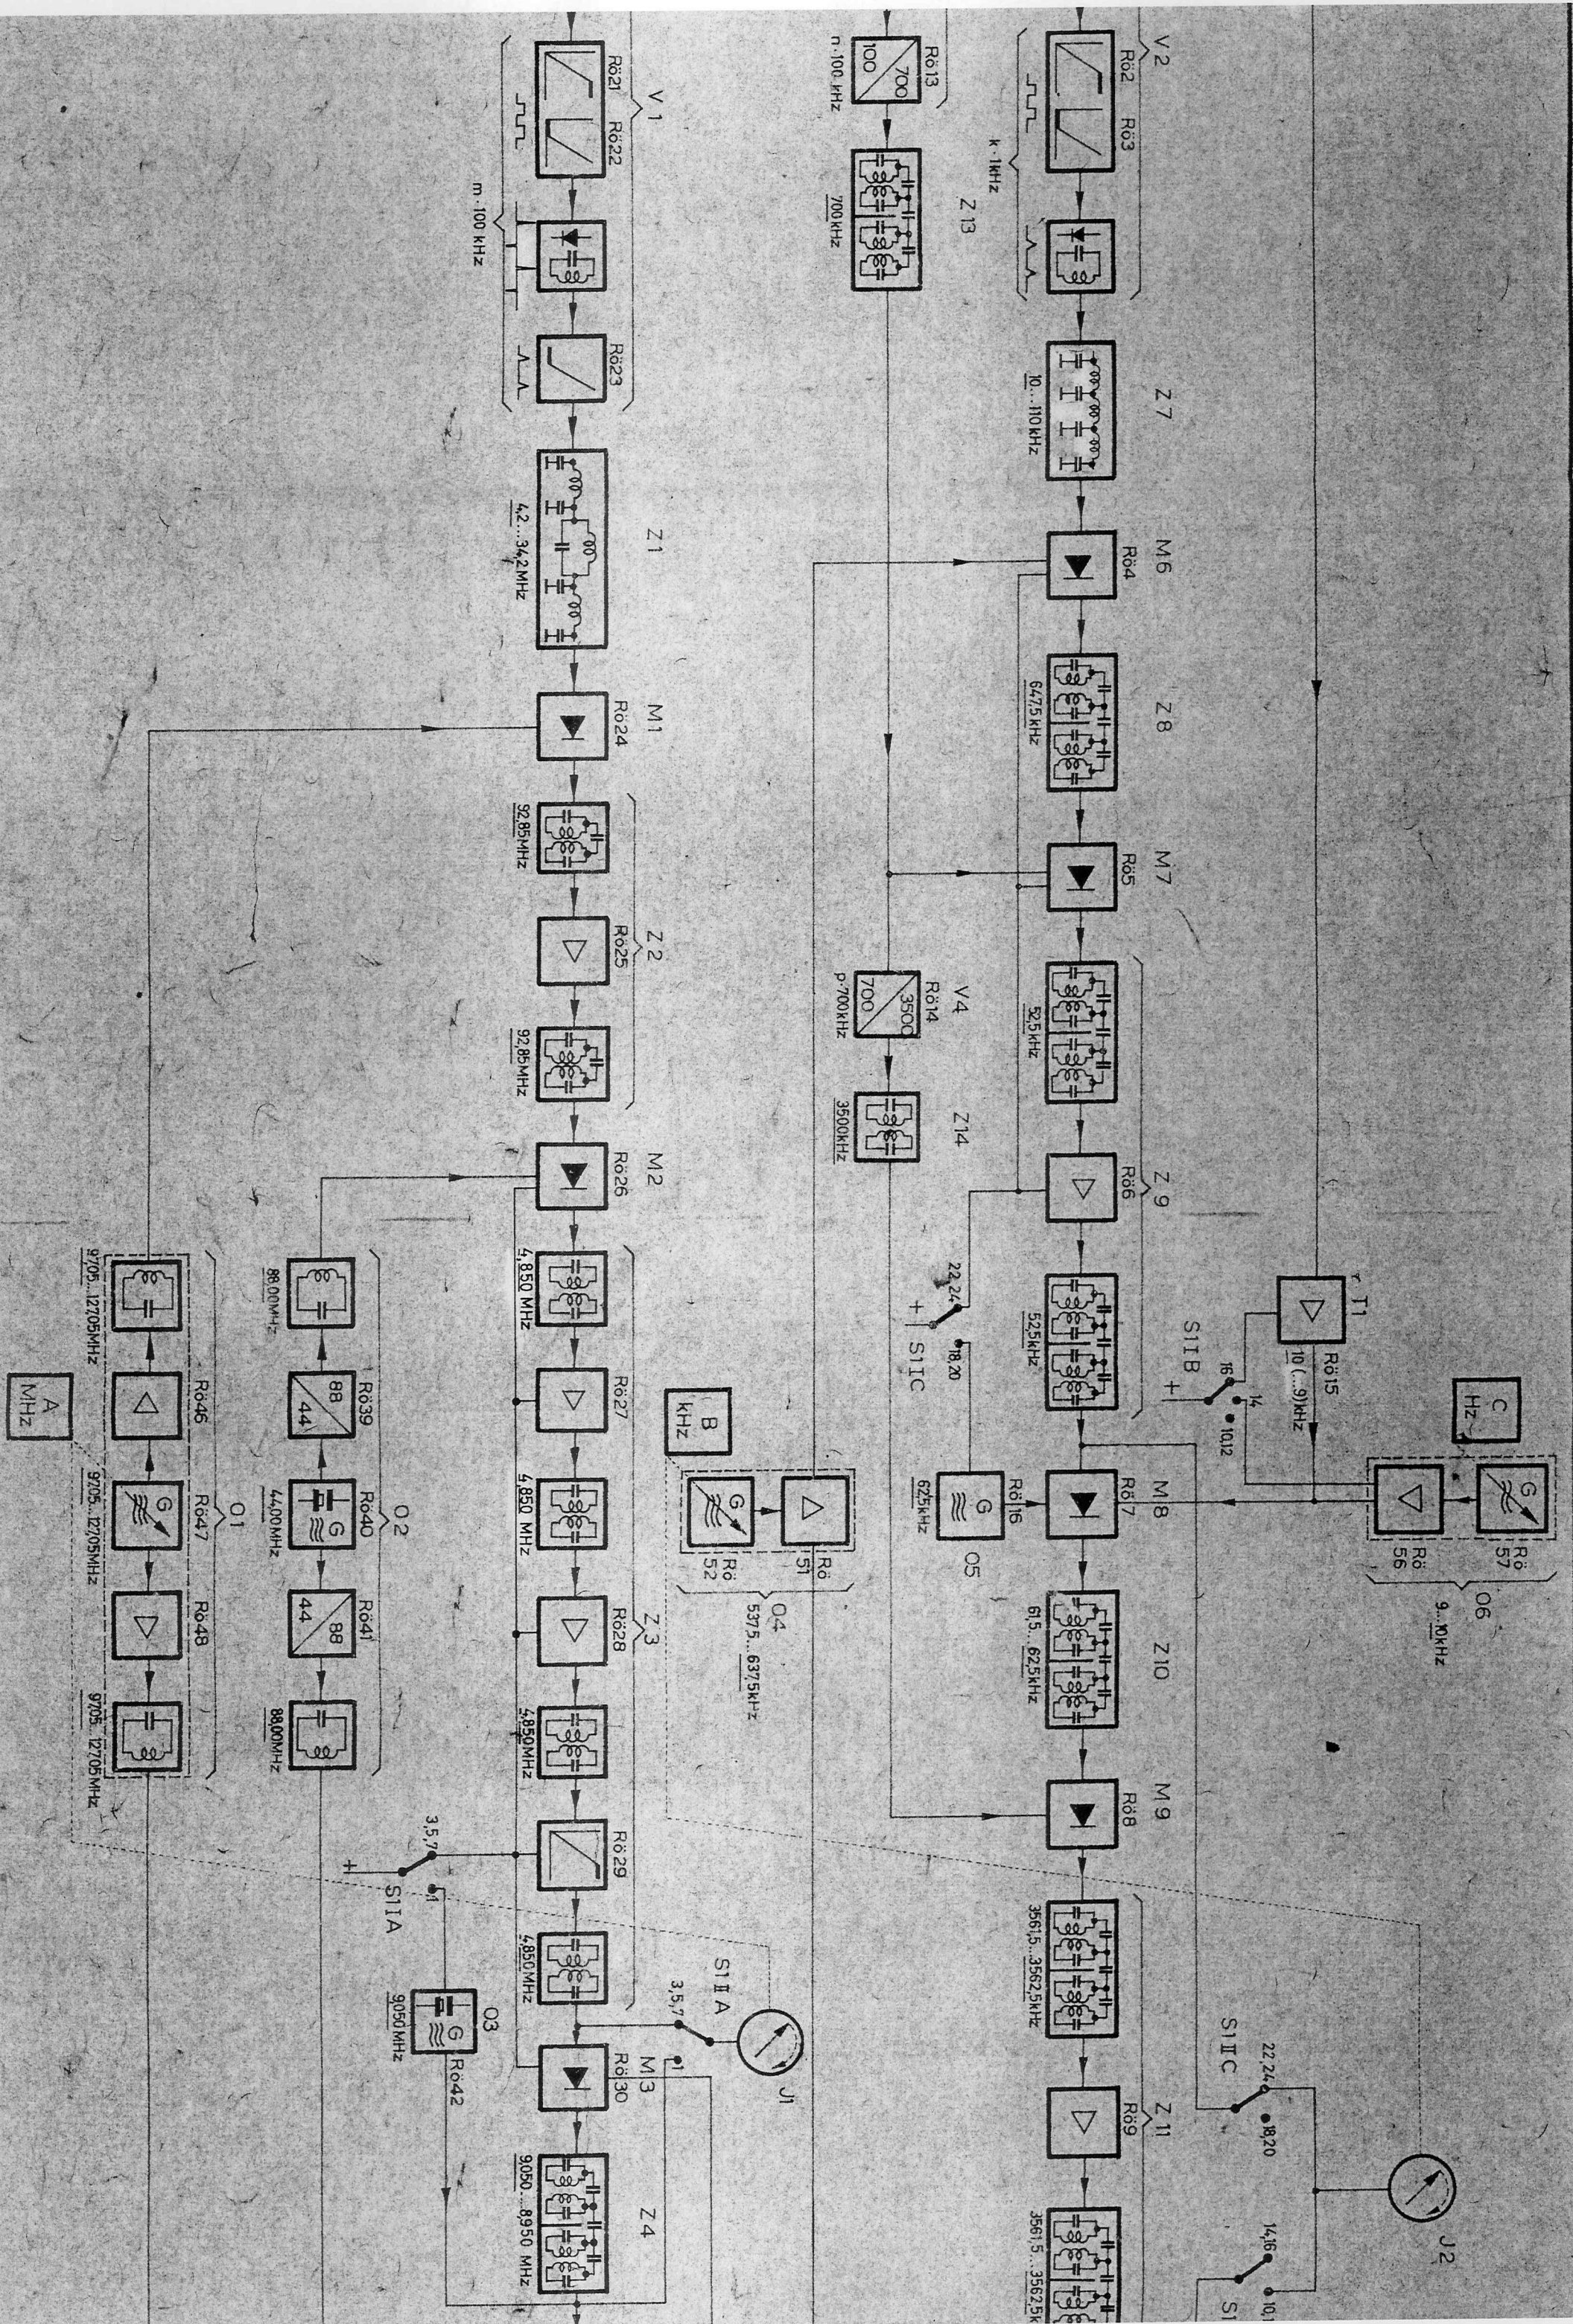

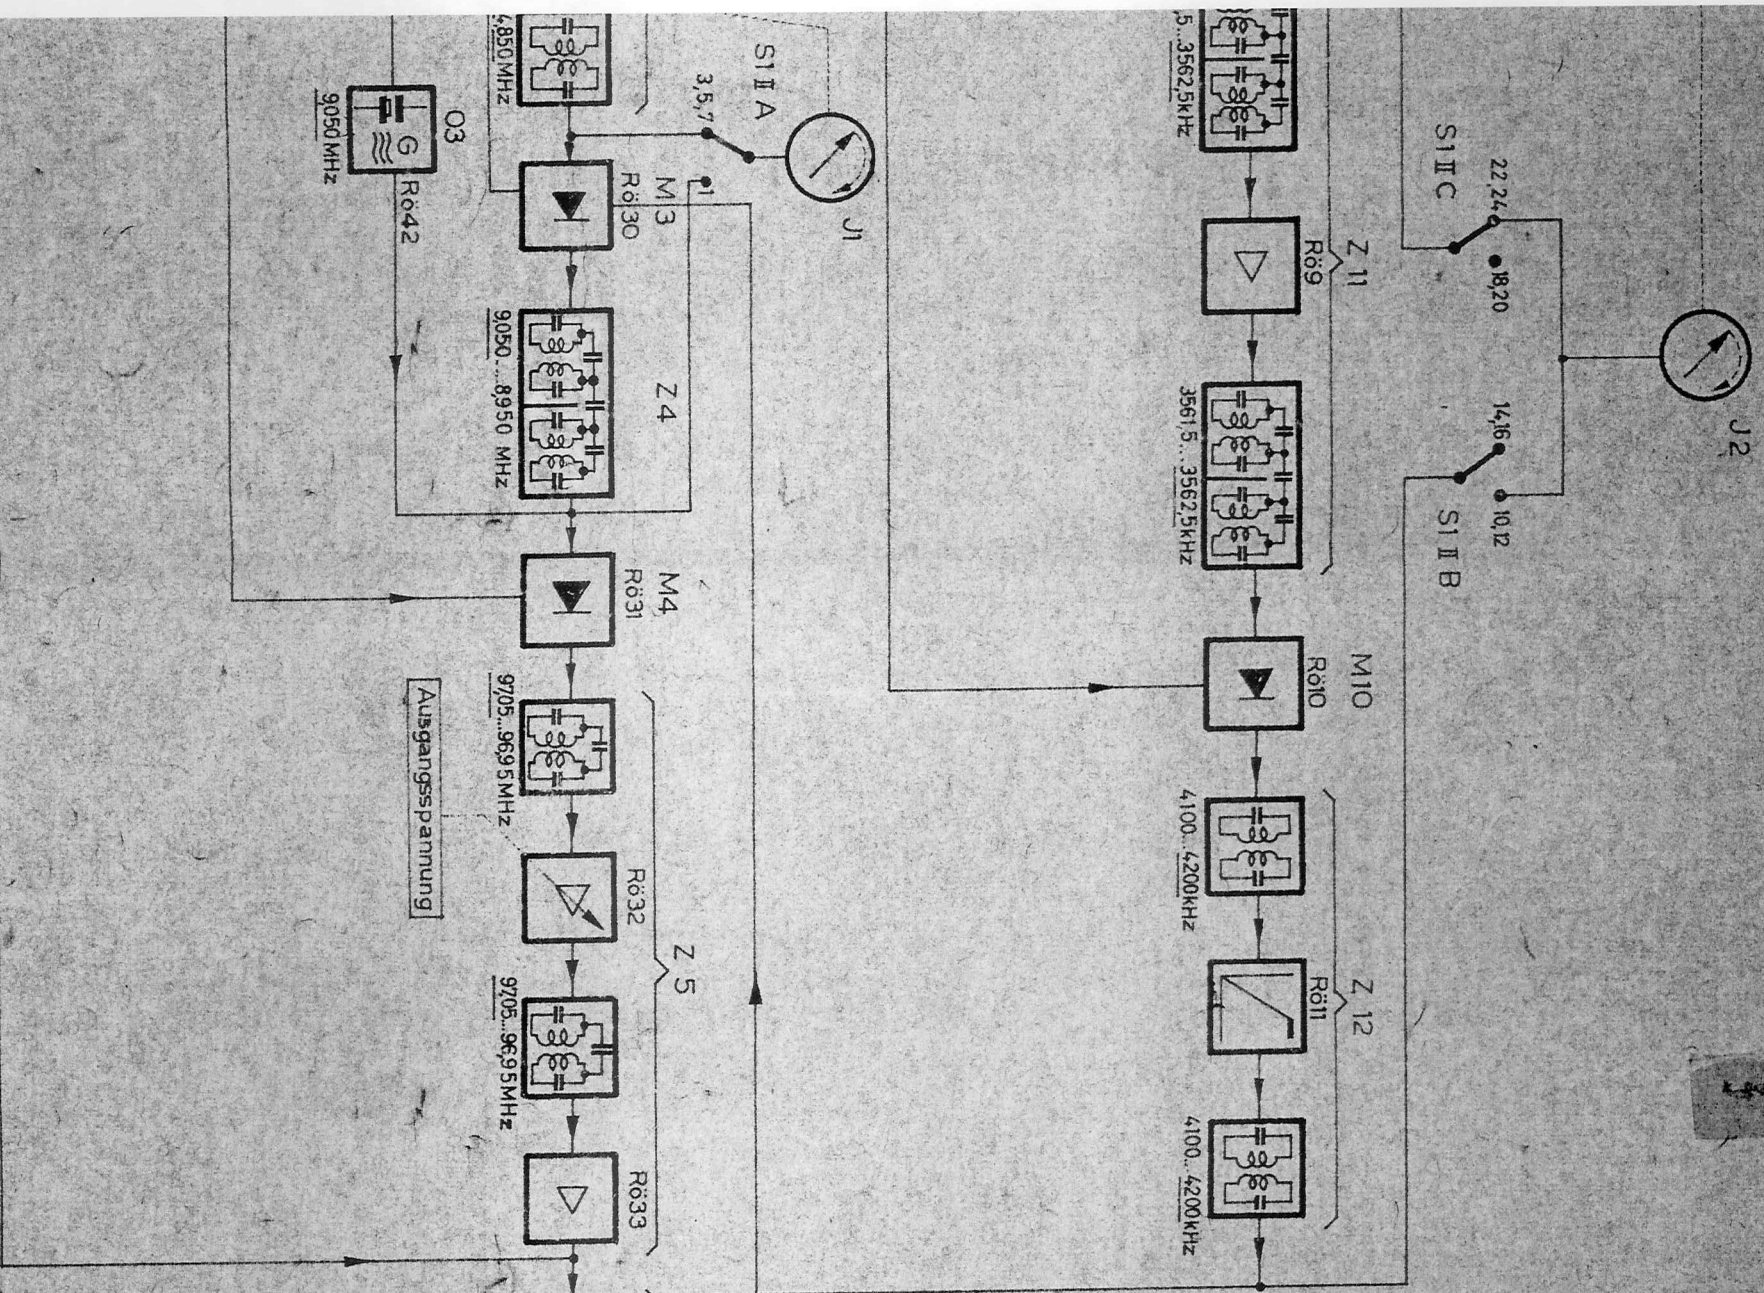

Betriebsart					
A	B	C	I	II	III/IV
1	2	3	4		
S1 I A	3,5,7				
S1 I B	10,12				
S1 I C	18,20				
S1 II A	3,5,7				
S1 II B	10,12				
S1 II C	18,20				
S1 I C	22,24				

Schaltierte Felder: Schalter geschlossen

■ stetig einstellbar
 L in Stufen einstellbar
 o unwirksam

1 V	0 db
300 mV	10 db
100 mV	20 db
30 mV	30 db
10 mV	40 db
3 mV	50 db
1 mV	60 db

Ausgang
 30 Hz...30 MHz
 R160Ω