



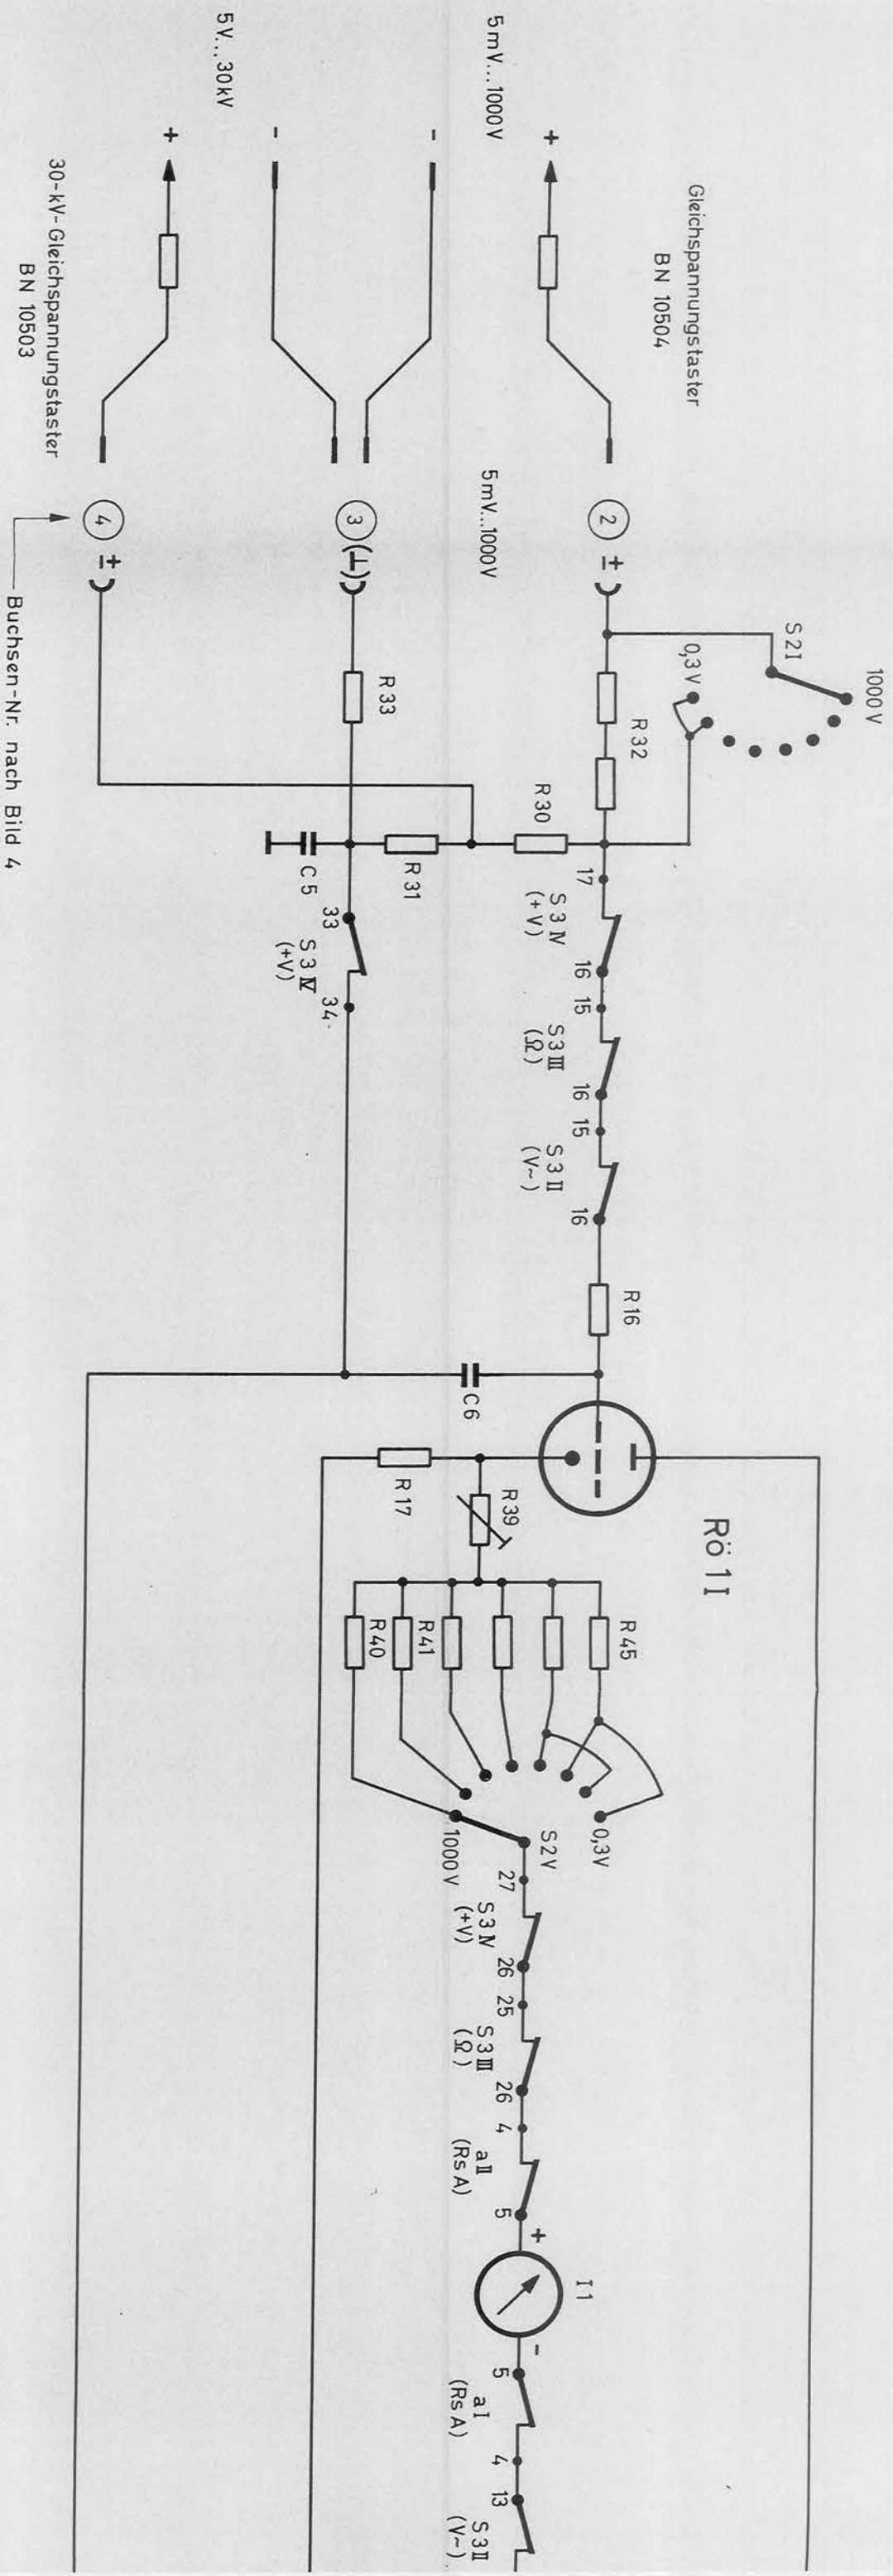

37	27	17
36	26	16
35	25	15
34	24	14
33	23	13
32	22	12
31	21	11

S3II...S3V

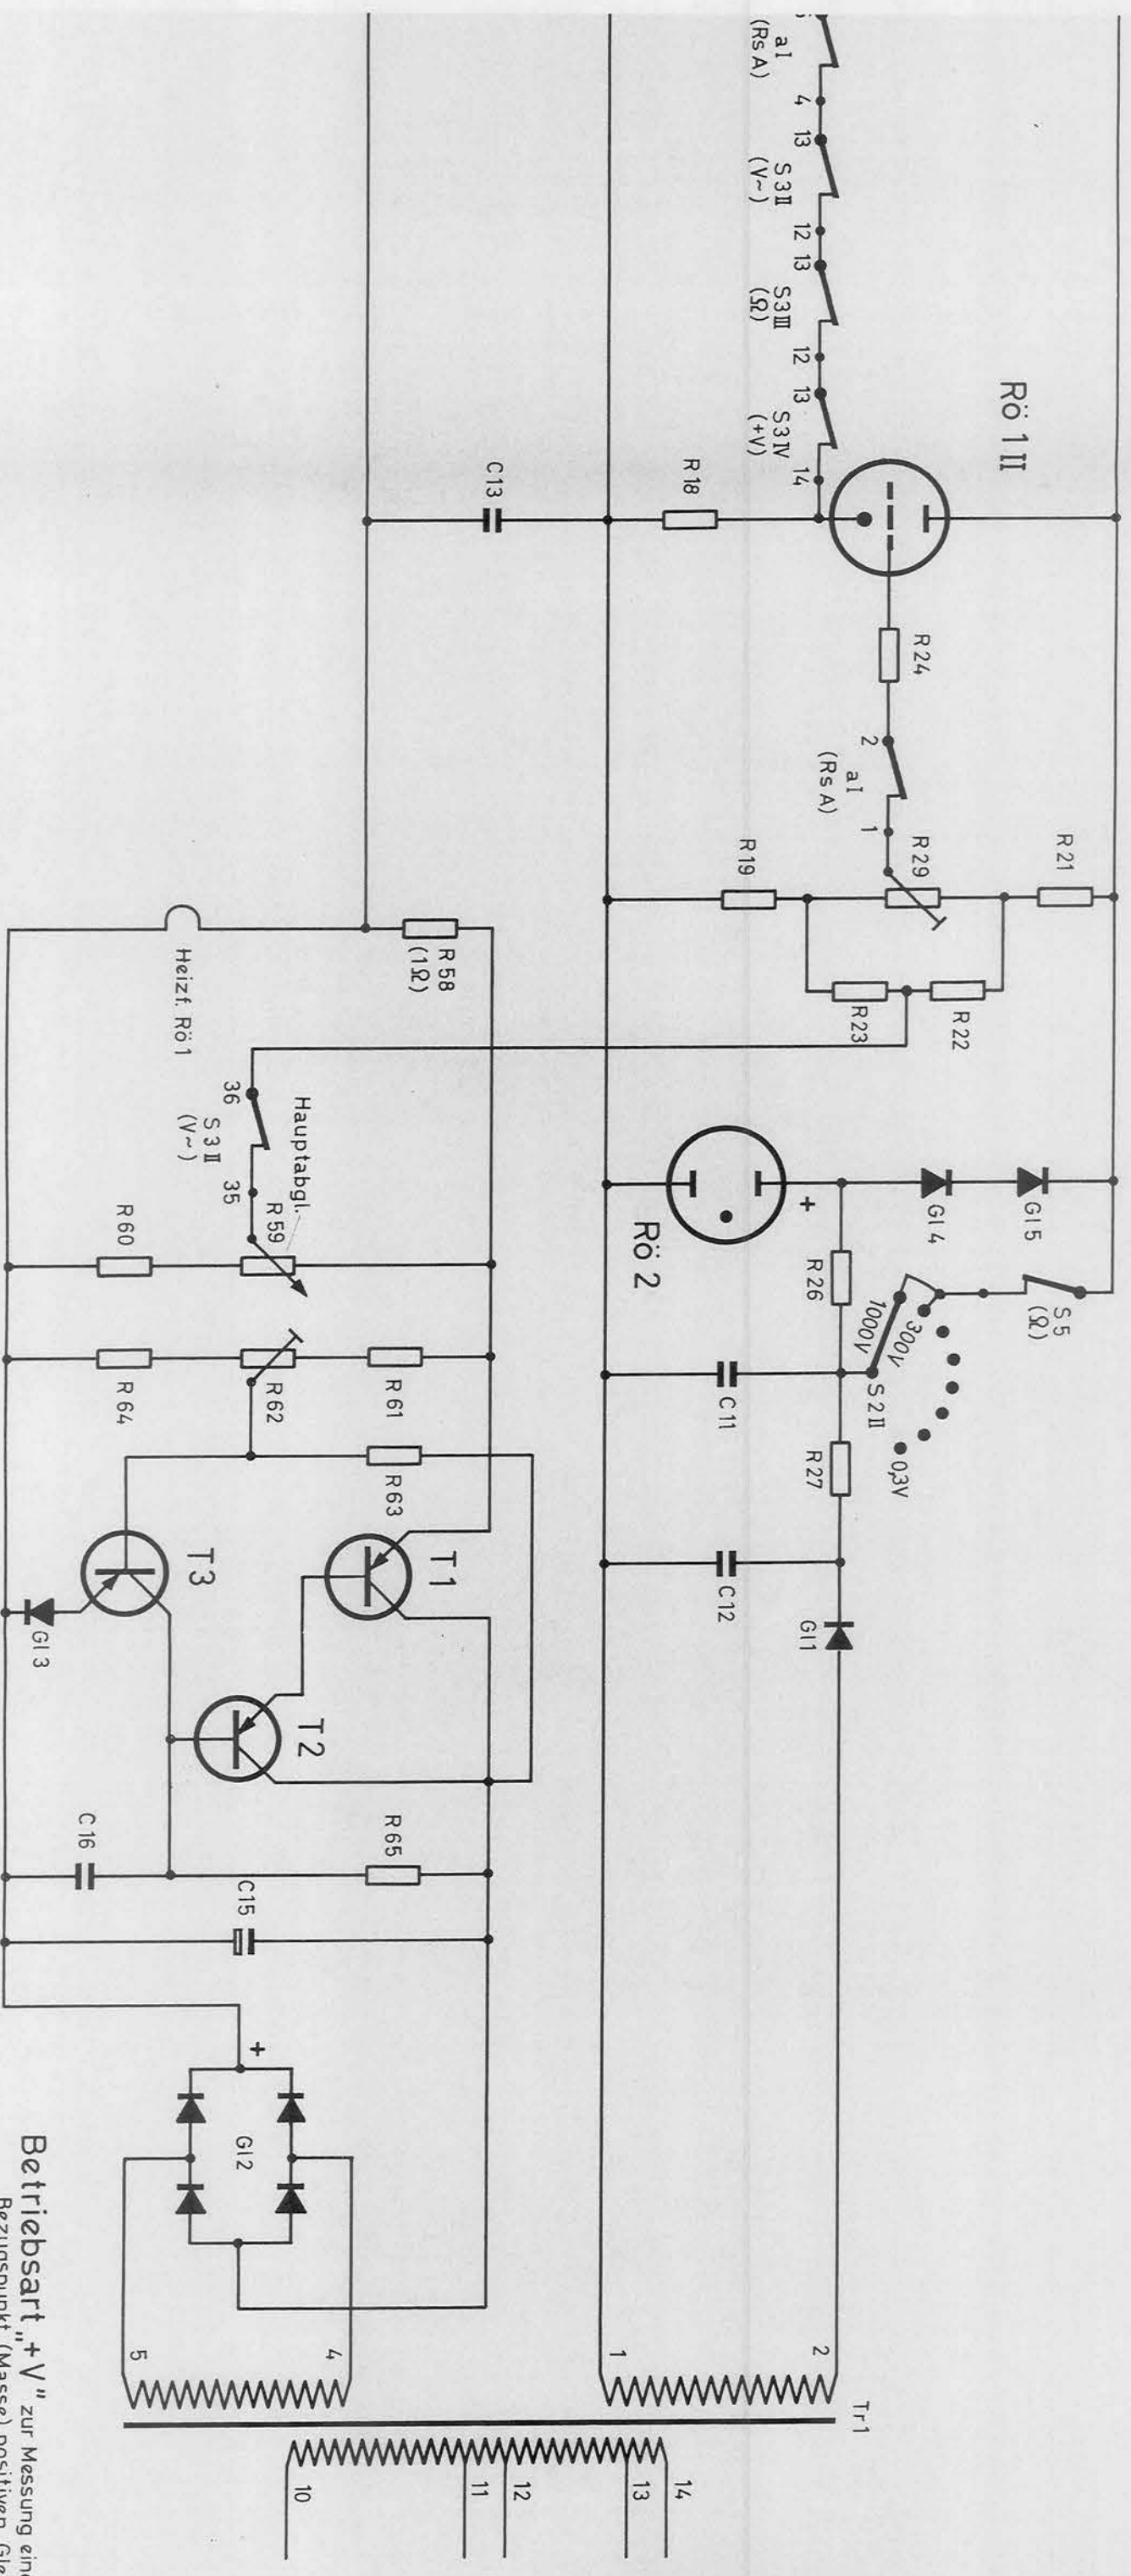

- Betriebsart „+V“ zur Messung einer geg. Bezugspunkt (Masse) positiven Gleichspa**
- A) mit Buchsen-Eingang 3-2 (5mV...1000 V)
 - B) mit Gleichspannungslaster BN 10504 über Buchsen-Eingang 3-2 (5mV...100)
 - C) mit 30-kV- Gleichspannungslaster BN 105 über Buchsen-Eingang 3-4 (5V...301